Totální náhrada humeru - tumorová cementovaná

Materiál: Korozivzdorná ocel (ISO 5832-1) - dřík, UHMWPE - náhrada

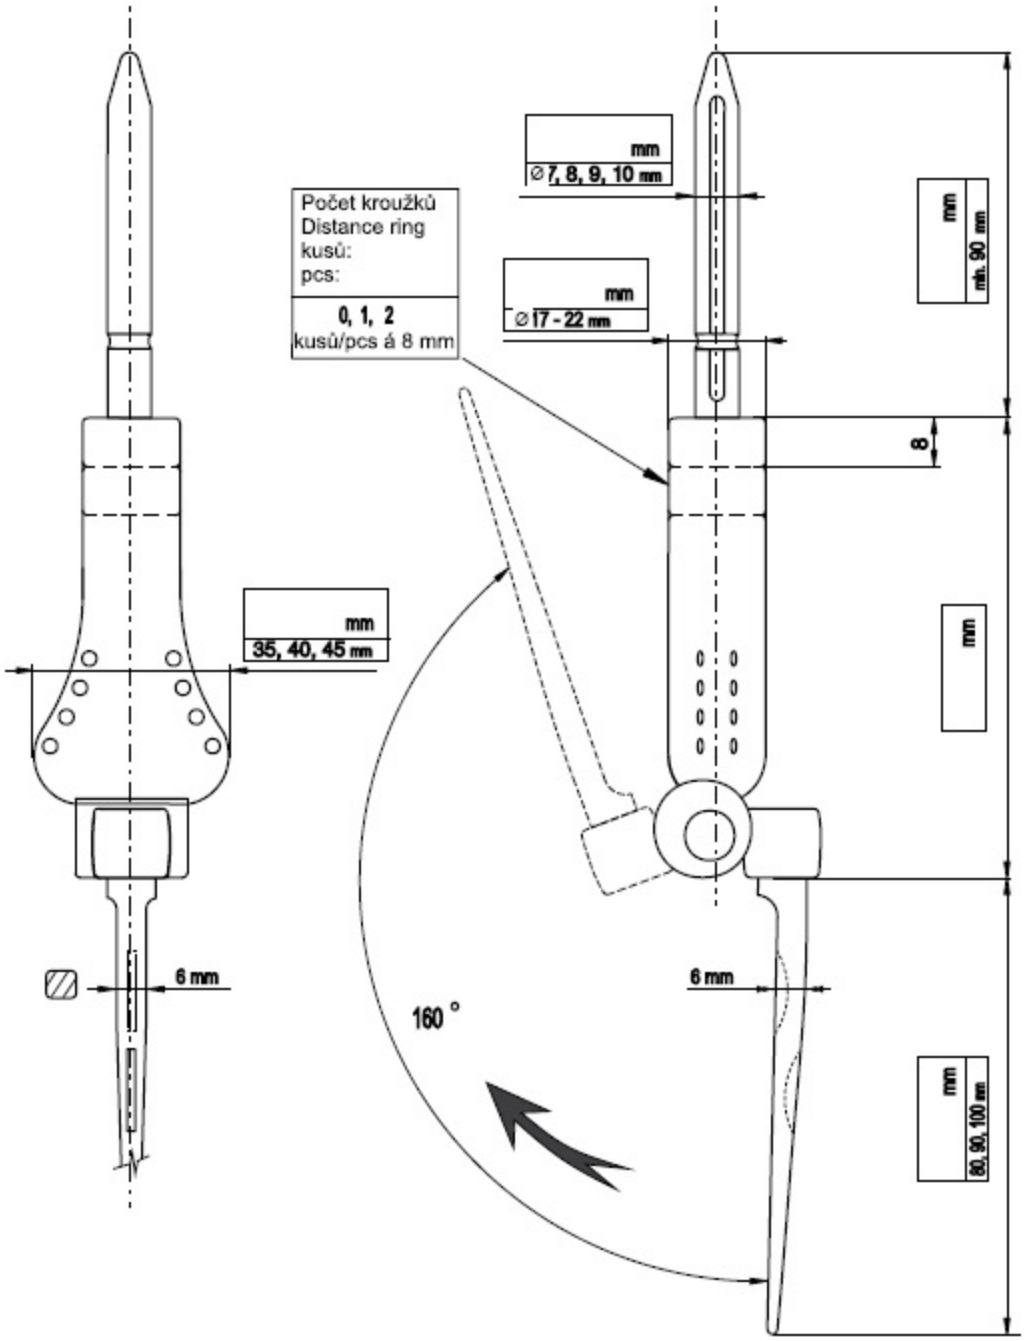

Informace o pacientovi:

Jméno: .....

Datum narození: .....

Bydliště: .....

Hmotnost: .....kg

Termín dodání: .....